



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

На медицинское изделие

**Камеры холодильные медицинские "Бирюса" по ТУ 28.25.13-020-07550181-2019**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников  
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,  
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д. 29**

Производитель

**Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников  
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,  
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д. 29**

Место производства медицинского изделия

**ООО "КЗХ "Бирюса", Россия, 660037, г. Красноярск, пр-кт им. газеты  
Красноярский рабочий, д. 29, стр. 112**

Номер регистрационного досье № РД-29334/61198 от 01.10.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **28.25.13.116**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах


приказом Росздравнадзора от 19 декабря 2019 года № 9530  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0047239



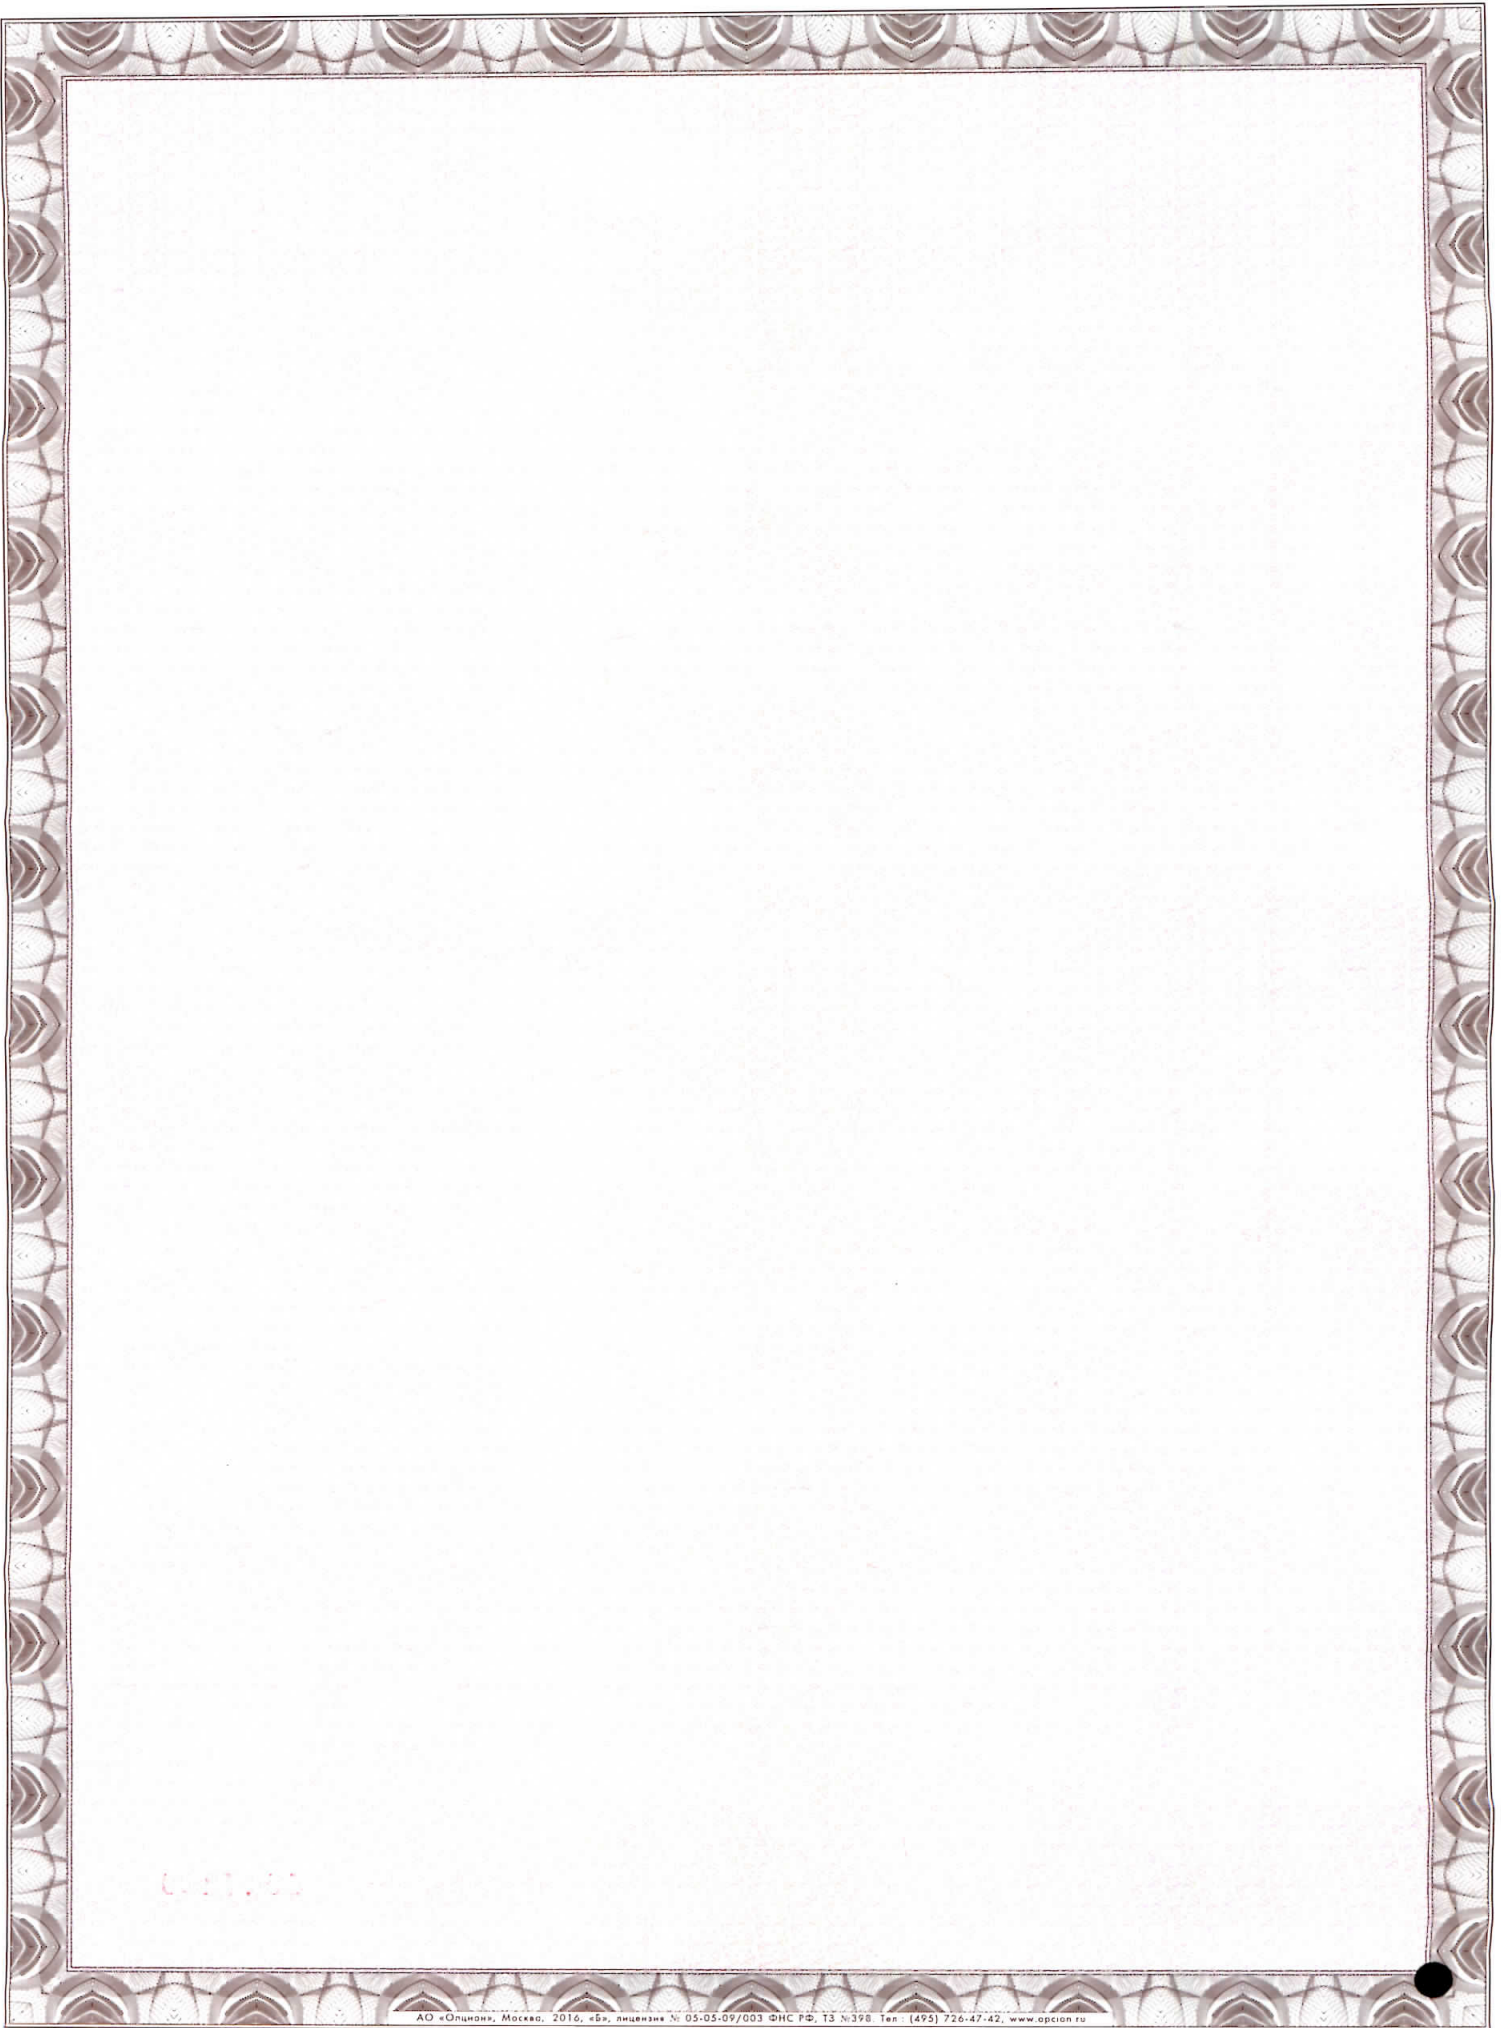

001.01

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

Лист 1

На медицинское изделие

**Камеры холодильные медицинские "Бирюса" по ТУ 28.25.13-020-07550181-2019,**  
вариантов исполнения:

I. Камера холодильная медицинская "Бирюса 150S-G", "Бирюса 150S-R",  
"Бирюса 150S-GB", "Бирюса 150S-RB", в составе:

1. Камера 150S - 1 шт.
2. Полка-решетка ПР150 - не более 3 шт. (при необходимости).
3. Полка-решетка средняя ПРС150 - не более 1 шт. (при необходимости).
4. Полка-решетка нижняя ПРН150 - не более 1 шт. (при необходимости).
5. Полка стеклянная ПС150 - не более 3 шт. (при необходимости).
6. Полка стеклянная средняя ПСС150 - не более 1 шт. (при необходимости).
7. Полка стеклянная нижняя ПСН150 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Ящик Я150 - не более 2 шт. (при необходимости).
9. Опора - 4 шт.
10. Вставка дренажная - 1 шт.
11. Ручка Р150 - 1 шт.
12. Винт - 3 шт.
13. Ключи от замка - 2 шт.
14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
15. Упаковка У150 - 1 шт.

II. Камера холодильная медицинская "Бирюса 250S-G", "Бирюса 250S-R",  
"Бирюса 250S-GB", "Бирюса 250S-RB", в составе:

1. Камера 250S - 1 шт.
2. Полка-решетка ПР250 - не более 5 шт. (при необходимости).
3. Полка-решетка нижняя ПРН250 - не более 1 шт. (при необходимости).
4. Полка стеклянная ПС250 - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Полка стеклянная нижняя ПСН250 - не более 1 шт. (при необходимости).
6. Ящик Я250 - не более 4 шт. (при необходимости).
7. Ящик верхний ЯВ250 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Ящик нижний ЯН250 - не более 1 шт. (при необходимости).
9. Опора - 2 шт.
10. Ручка Р250 - 1 шт.
11. Винт - 3 шт.
12. Нижняя накладка - 1 шт.
13. Защелка - 2 шт.
14. Ключи от замка - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0060376**





**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

Лист 2

15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Упаковка У250 - 1 шт.

III. Камера холодильная медицинская "Бирюса 280S-G", "Бирюса 280S-R", "Бирюса 280S-GB", "Бирюса 280S-RB", в составе:

1. Камера 280S - 1 шт.

2. Полка-решетка ПР150 - не более 5 шт. (при необходимости).

3. Полка-решетка средняя ПРС150 - не более 1 шт. (при необходимости).

4. Полка-решетка нижняя ПРН150 - не более 1 шт. (при необходимости).

5. Полка стеклянная ПС150 - не более 5 шт. (при необходимости).

6. Полка стеклянная средняя ПСС280 - не более 1 шт. (при необходимости).

7. Полка стеклянная нижняя ПСН150 - не более 1 шт. (при необходимости).

8. Ящик Я150 - не более 2 шт. (при необходимости).

9. Опора - 4 шт.

10. Вставка дренажная - 1 шт.

11. Ручка Р150 - 1 шт.

12. Винт - 3 шт.

13. Ключи от замка - 2 шт.

14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Упаковка У150 - 1 шт.

IV. Камера холодильная медицинская "Бирюса 350S-G", "Бирюса 350S-R", "Бирюса 350S-GB", "Бирюса 350S-RB", в составе:

1. Камера 350S - 1 шт.

2. Полка-решетка ПР150 - не более 7 шт. (при необходимости).

3. Полка стеклянная ПС150 - не более 7 шт. (при необходимости).

4. Ящик Я350 - не более 2 шт. (при необходимости).

5. Опора - 4 шт.

6. Вставка дренажная - 1 шт.

7. Ручка Р150 - 1 шт.

8. Винт - 3 шт.

9. Панель цокольная - 1 шт.

10. Уголок - 2 шт.

11. Ключи от замка - 2 шт.

12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Упаковка У150 - 1 шт.


V. Камера холодильная медицинская "Бирюса 450S-G", "Бирюса 450S-R", "Бирюса 450S-GB", "Бирюса 450S-RB", в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0060377**



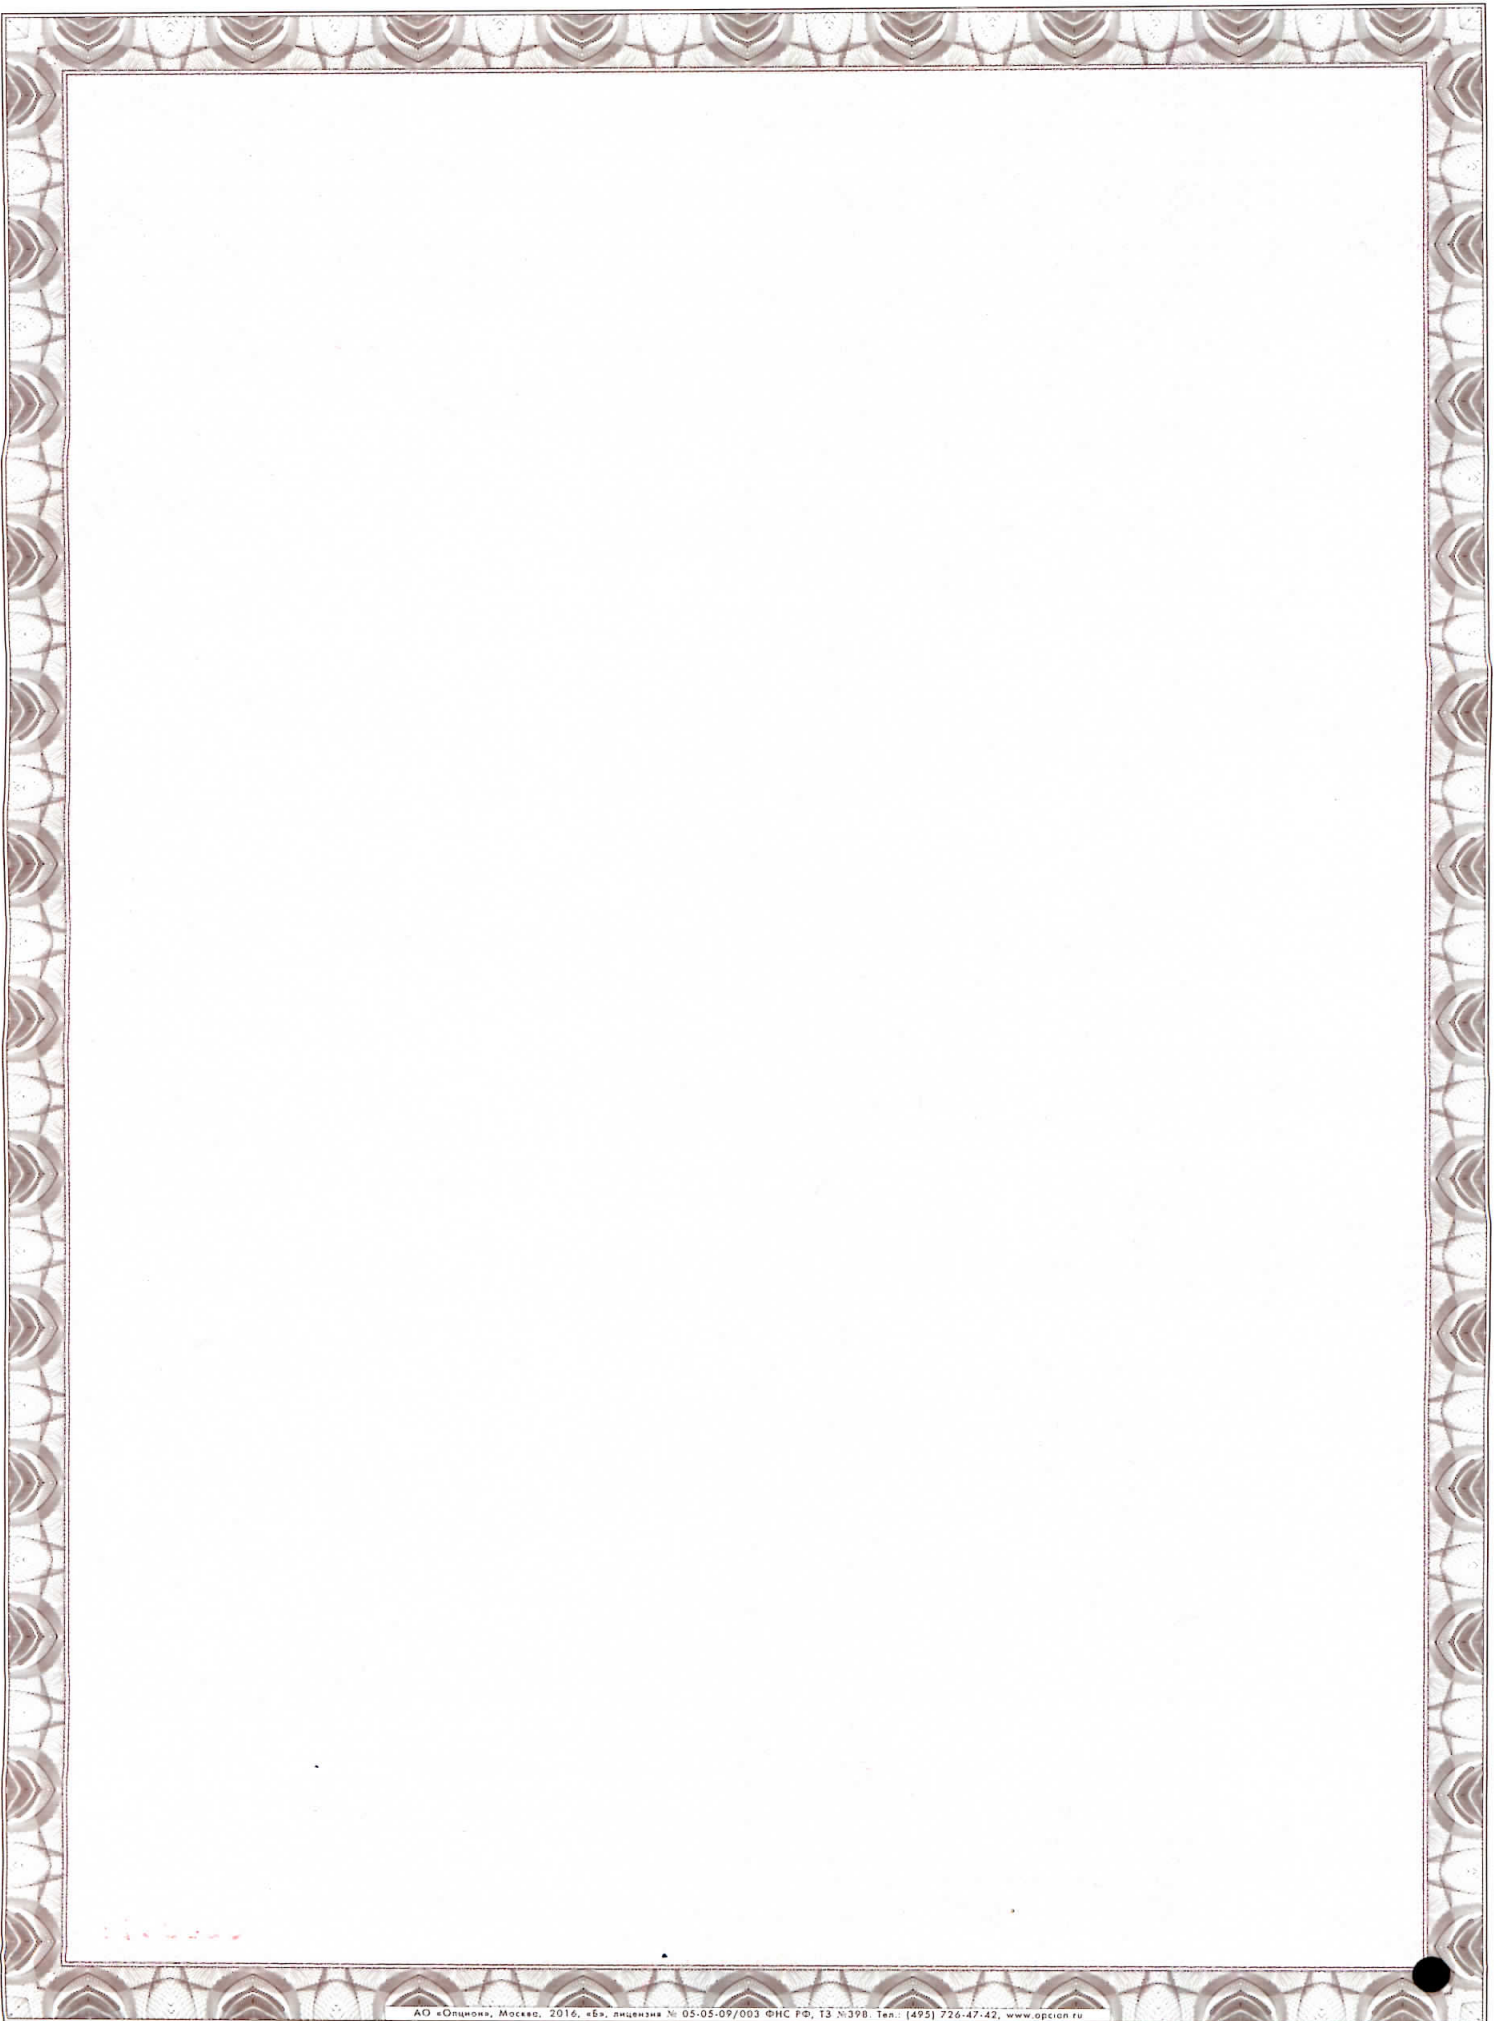

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

Лист 3

1. Камера 450S - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР550 - не более 7 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС550 - не более 7 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я550 - не более 5 шт. (при необходимости).
  5. Ящик нижний ЯН550 - не более 1 шт. (при необходимости).
  6. Ручка Р550 - 1 шт.
  7. Винт - 3 шт.
  8. Ключи от замка - 2 шт.
  9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  10. Упаковка У550 - 1 шт.
- VI. Камера холодильная медицинская "Бирюса 550S-G", "Бирюса 550S-R", "Бирюса 550S-GB", "Бирюса 550S-RB", в составе:
1. Камера 550S - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР550 - не более 8 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС550 - не более 8 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я550 - не более 6 шт. (при необходимости).
  5. Ящик нижний ЯН550 - не более 1 шт. (при необходимости).
  6. Ручка Р550 - 1 шт.
  7. Винт - 3 шт.
  8. Ключи от замка - 2 шт.
  9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  10. Упаковка У550 - 1 шт.
- VII. Камера холодильная медицинская "Бирюса 750S-G", "Бирюса 750S-R", "Бирюса 750S-GB", "Бирюса 750S-RB", в составе:
1. Камера 750S - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР750 - не более 8 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС750 - не более 8 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я750 - не более 6 шт. (при необходимости).
  5. Ящик нижний ЯН750 - не более 1 шт. (при необходимости).
  6. Ручка Р550 - 1 шт.
  7. Винт - 3 шт.
  8. Ключи от замка - 2 шт.
  9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  10. Упаковка У550 - 1 шт.
- VIII. Камера холодильная медицинская "Бирюса 150K-G", "Бирюса 150K-R", "Бирюса 150K-GB", "Бирюса 150K-RB", в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0060378**







**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

Лист 4

1. Камера 150К - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР150 - не более 2 шт. (при необходимости).
  3. Полка-решетка средняя ПРС150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  4. Полка-решетка нижняя ПРН150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  5. Полка стеклянная ПС150 - не более 2 шт. (при необходимости).
  6. Полка стеклянная средняя ПСС150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  7. Полка стеклянная нижняя ПСН150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  8. Ящик Я150 - не более 2 шт. (при необходимости).
  9. Опора - 4 шт.
  10. Вставка дренажная - 1 шт.
  11. Ручка Р150 - 1 шт.
  12. Винт - 3 шт.
  13. Ключи от замка - 2 шт.
  14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  15. Упаковка У150 - 1 шт.
- IX. Камера холодильная медицинская "Бирюса 250К-G", "Бирюса 250К-R", "Бирюса 250К-GB", "Бирюса 250К-RB", в составе:
1. Камера 250К - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР250 - не более 5 шт. (при необходимости).
  3. Полка-решетка нижняя ПРН250 - не более 1 шт. (при необходимости).
  4. Полка стеклянная ПС250 - не более 5 шт. (при необходимости).
  5. Полка стеклянная нижняя ПСН250 - не более 1 шт. (при необходимости).
  6. Ящик Я250 - не более 4 шт. (при необходимости).
  7. Ящик верхний ЯВ250 - не более 1 шт. (при необходимости).
  8. Ящик нижний ЯН250 - не более 1 шт. (при необходимости).
  9. Опора - 2 шт.
  10. Ручка Р250 - 1 шт.
  11. Винт - 3 шт.
  12. Нижняя накладка - 1 шт.
  13. Защелка - 2 шт.
  14. Ключи от замка - 2 шт.
  15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  16. Упаковка У250 - 1 шт.

X. Камера холодильная медицинская "Бирюса 280К-G", "Бирюса 280К-R", "Бирюса 280К-GB", "Бирюса 280К-RB", в составе:

1. Камера 280К - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0060379**





**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

Лист 5

2. Полка-решетка ПР150 - не более 5 шт. (при необходимости).
  3. Полка-решетка средняя ПРС150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  4. Полка-решетка нижняя ПРН150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  5. Полка стеклянная ПС150 - не более 5 шт. (при необходимости).
  6. Полка стеклянная средняя ПСС280 - не более 1 шт. (при необходимости).
  7. Полка стеклянная нижняя ПСН150 - не более 1 шт. (при необходимости).
  8. Ящик Я150 - не более 2 шт. (при необходимости).
  9. Опора - 4 шт.
  10. Вставка дренажная - 1 шт.
  11. Ручка Р150 - 1 шт.
  12. Винт - 3 шт.
  13. Ключи от замка - 2 шт.
  14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  15. Упаковка У150 - 1 шт.
- XI. Камера холодильная медицинская "Бирюса 350К-G", "Бирюса 350К-R", "Бирюса 350К-GB", "Бирюса 350К-RB", в составе:
1. Камера 350К - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР150 - не более 7 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС150 - не более 7 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я350 - не более 2 шт. (при необходимости).
  5. Опора - 4 шт.
  6. Вставка дренажная - 1 шт.
  7. Ручка Р150 - 1 шт.
  8. Винт - 3 шт.
  9. Панель цокольная - 1 шт.
  10. Уголок - 2 шт.
  11. Ключи от замка - 2 шт.
  12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  13. Упаковка У150 - 1 шт.
- XII. Камера холодильная медицинская "Бирюса 450К-G", "Бирюса 450К-R", "Бирюса 450К-GB", "Бирюса 450К-RB", в составе:
1. Камера 450К - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР550 - не более 7 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС550 - не более 7 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я550 - не более 5 шт. (при необходимости).
  5. Ящик нижний ЯН550 - не более 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0060380**





**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2019 года № РЗН 2019/9387

Лист 6

6. Ручка Р550 - 1 шт.
  7. Винт - 3 шт.
  8. Ключи от замка - 2 шт.
  9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  10. Упаковка У550 - 1 шт.
- XIII. Камера холодильная медицинская "Бирюса 550К-G", "Бирюса 550К-R", "Бирюса 550К-GB", "Бирюса 550К-RB", в составе:
1. Камера 550К - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР550 - не более 8 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС550 - не более 8 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я550 - не более 6 шт. (при необходимости).
  5. Ящик нижний ЯН550 - не более 1 шт. (при необходимости).
  6. Ручка Р550 - 1 шт.
  7. Винт - 3 шт.
  8. Ключи от замка - 2 шт.
  9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  10. Упаковка У550 - 1 шт.
- XIV. Камера холодильная медицинская "Бирюса 750К-G", "Бирюса 750К-R", "Бирюса 750К-GB", "Бирюса 750К-RB", в составе:
1. Камера 750К - 1 шт.
  2. Полка-решетка ПР750 - не более 8 шт. (при необходимости).
  3. Полка стеклянная ПС750 - не более 8 шт. (при необходимости).
  4. Ящик Я750 - не более 6 шт. (при необходимости).
  5. Ящик нижний ЯН750 - не более 1 шт. (при необходимости).
  6. Ручка Р550 - 1 шт.
  7. Винт - 3 шт.
  8. Ключи от замка - 2 шт.
  9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  10. Упаковка У550 - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0060381

